


CAMARA DE NEUBAUER LINEA CLARA.



Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG

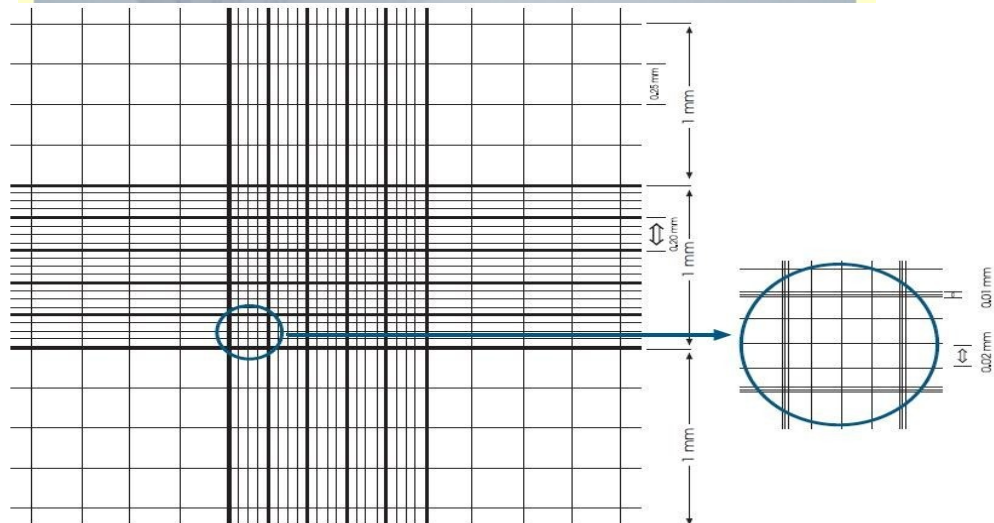

División doble del retículo, incl. 2 cubreobjetos de vidrio para hemacitómetro, con número LOT en el envase, marcado: utilizable hasta, CE según IVD 98/79 CE.